



Universität Regensburg

Universität Regensburg · D-93040 Regensburg

AN ALLE EINSENDER

FAKULTÄT
MEDIZIN

Institut für Medizinische
Mikrobiologie und Hygiene

Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Institutsleitung
Prof. Dr. Dr. André Gessner

Bakteriologie

Telefon +49 941 944-6410
Telefax +49 941 944-6402
Franz-Josef-Strauss-Allee 11
D-93053 Regensburg

bakteriologie.mmh@klinik.uni-regensburg.de
www.uni-regensburg.de

29.10.2014

Betreff: CHARGENRÜCKRUF

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

seit Mitte Oktober sind in der Blutkulturdiagnostik vermehrt falsch-positive anaerobe Blutkulturflaschen aufgefallen (d.h. im Bebrütungsgerät wird ein positives Signal erzeugt, obwohl in der Probe weder mikroskopisch noch kulturell ein Erreger nachgewiesen werden kann).

Wir bitten Sie daher, anaerobe Blutkulturflaschen der Charge 4164960 nicht mehr zu verwenden und Ihr Lager auf Restbestände dieser Charge zu überprüfen! Bitte senden Sie Restbestände dieser Charge zurück in unser Labor!

Wir bitten Sie um Weiterleitung dieser Information an Ihre zuständigen Mitarbeiter (vgl. auch Anhang).

Vielen Dank und mit besten Grüßen aus der Mikrobiologie,

Prof. Dr. Dr. A. Gessner
(Institutsleiter)

PD Dr. W. Schneider
(Bereichsleiter)

Dr. M. Simon
(Fachärztin)

**BITTE ANAEROBE FLASCHEN DER CHARGE 4164960 ZURÜCK IN DIE MIKROBIOLOGIE!
FLASCHEN DIESER CHARGE NICHT MEHR VERWENDEN!**


Wo findet sich die Chargennummer?

1) auf der Blutkulturflasche

2) auf dem Karton



**Diese Charge bitte zurück
an die Mikrobiologie!!!**

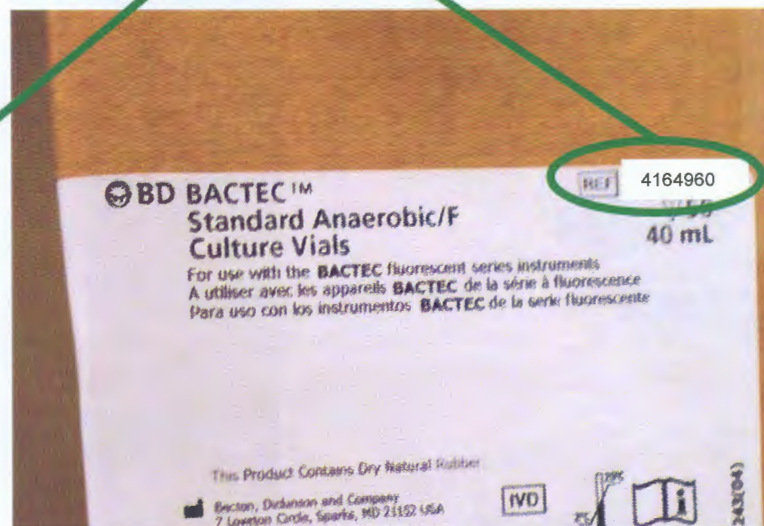

Stand 29.10.2014, Institut für Mikrobiologie und Hygiene, Regensburg